

quest 4.0

ADJUSTABLE BASE

LIT AJUSTABLE



ADJUSTABLE BASE | OWNER'S MANUAL LIT AJUSTABLE | MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Actual product appearance and functionality may vary from photographs, illustrations and descriptions included in this manual.
L'apparence et les fonctionnalités du produit peuvent différer de la photo, des illustrations et des descriptions incluent dans ce manuel.

Table of contents

Table des matières

ENGLISH

Safety Precautions and Usage Statements	1-3
Parts List	4
Base and Remote Overview	5
Quick Reference Guide	6
Installation Guide	7-8
Offline Voice Control Puck with Wireless Charger	9-11
Remote Control	12-13
Remote Control Pairing & Child Lock	14
Connecting Strap (optional)	15
Syncing Two Bases (optional)	16
Headboard Brackets (optional)	17
Emergency Battery Backup Strap	18
Troubleshooting	19

FRANÇAIS

Consignes de sécurité et d'utilisation	21-23
Liste des pièces	24
Vue d'ensemble : lit et télécommande	25
Guide de référence rapide	26
Guide d'installation	27-28
Rondelle de commandes vocales / chargeur sans fil	29-31
Télécommande	32-33
Synchronisation de la télécommande et verrouillage parental	34
Sangle de raccordement (facultatif)	35
Synchronisation de deux lits (facultatif)	36
Équerres de tête de lit (facultatif)	37
Courroie pour les piles d'urgence	38
Dépannage	39

Safety Precautions and Usage Statements

Attention: Important Safety Disclaimers

Read the following information before using this product. Failure to use a surge protection device could compromise safety or cause product malfunction and could void the electrical portion of your warranty.

TO REDUCE THE RISK OF SHOCK, BURNS, FIRE OR INJURY:

For optimal safety and operation, plug bed base into a surge protector (not included). The bed base should only be plugged directly into a wall outlet or surge protector (strongly recommended). Always unplug the base from the electrical outlet before servicing any part of the base. To reduce risk of electric shock, unplug the base before cleaning. To safely disconnect, ensure the base is in a flat position with all motors off, and unplug from power source. Keep the power cord away from heated surfaces. Never operate the base when the air openings are blocked. Keep air openings free of lint, hair and the like. Do not drop or insert any object into any opening. Discontinue use of the bed base and contact a qualified service center if: it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or it has been dropped into water. Only use this bed base for its intended use as described in this manual. Do not use accessories/attachments that are not recommended by the manufacturer. Close supervision is required when the bed base is used by or near children, convalescents, disabled persons or pets. Improper connection of the equipment can result in the risk of electrical shock, electrical fire or faulty operation of this bed base. If the plug does not fit your outlet, contact a qualified electrician to install a suitable outlet. Unauthorized modification or failure to use a wall outlet or surge protector could void the electrical portion of your warranty.

CHILDREN AND PETS:

Immediately dispose of all packing materials as it may pose a smothering risk to small children and pets. To avoid injury, it is not advised to allow children and small pets to play on or under the bed. Children should not operate the bed base without adult supervision.

SAFETY FEATURES:

Manual operation – If something gets caught in the platform when flattened, you can manually raise the platform up by lifting at both the head and foot to relieve pressure and allow for release.

Emergency stop – Stop the motion of the platform by pressing any button on the remote control.

Power outage – Use the “Emergency Battery Backup Strap” as a temporary power source to get the base to a desired position. Instructions on how to operate the Battery Backup Box are on the Emergency Battery Backup page(s).

Child-lockout – This remote control is programmed with a child-lock safety feature. Information on activation and deactivation of this feature can be found on the Remote Control page(s) and on the back of your remote control.

PACEMAKERS:

Some products contain Neodymium MAGNETS which may interfere with devices such as pacemakers, ICD's and any other device sensitive to magnetic fields. It is STRONGLY recommended that owners of such medical devices consult their physician prior to using products that contain Neodymium MAGNETS. It is also possible that some pacemakers may falsely interpret the optional massage feature vibrations as movement/exercise. This is a common occurrence with any product that creates a vibrating movement and may affect the pacemaker. Please consult your physician before using the massage feature.

IN-HOME USE AND HOSPITAL STANDARDS:

Ergo adjustable bed bases are designed solely for in-home use. This base was not designed as a hospital bed and is not designed to meet hospital standards. Do not use this base with TENT TYPE oxygen therapy equipment or near explosive gases.

ADDITIONAL SAFETY FEATURES

Casters (optional leg accessory) are equipped with locking wheels to prevent unwanted movement. Even when locked and unable to roll, it is possible for the casters to slide. Free release head and foot motors are designed to lower

Safety Precautions and Usage Statements

the mattress by retracting only with gravity, never pulling downwards, which minimizes pinch points.

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal. During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This contact may result in metal on metal or metal on plastic contact. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position. In normal base operation, the wheels, which allow the bed to maintain its distance from the wall, will make contact with the steel platform supports of the base creating a contact noise. When entering, exiting or shifting weight on the base, this contact noise may be audible as the wheels make contact. This is normal.

MATERIALS

Ergo adjustable bases are constructed from various materials including woods, metals, plastics and fabrics. Tension, pressure or movement applied to the frame, platform or shroud through general use may create an audible sound.


MESSAGE OPERATION AND LOCATION ENVIRONMENT

The massage feature will emit a tone during operation. This is normal. As the massage intensity level is increased, the tone will intensify. The volume of this tone is directly related to the location environment. For example, when demonstrated in a show room, the surrounding environmental noise will cover some of the massage noise. However, when installed in a home setting with wooden floors, carpeted or not, the massage volume will be more noticeable. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base. It is possible to experience vibration or noise from the exterior bed frame, headboard brackets, headboards or footboards if mounting bolts are not firmly tightened.

Levels 1-6 of massage intensity represent the revolutions of the motor per minute. Level 6 provides the maximum number of RPMs. However, this does not mean that the feeling of vibration is the strongest. Depending on the mattress material, thickness, and positioning of the user, the feeling of vibrations will differ. We encourage the user to find the massage intensity setting that suits them best. It is important to understand the physics of vibrations. Just as an engine may run rough during idle, as the RPMs increase, the vibrations change concurrently.

TOLERANCE

All Ergo adjustable foundations, depending on make and model, are designed and manufactured to perform and function within designated quality control parameters. Bases are subject to meticulous and rigorous inspections during the quality control process to ensure bases will operate within these standards during normal operating use. Normal operating use is defined as the following: Adjustable foundation is to be operated with a mattress and load. Testing procedures require lifetime cycle tests with up to 120kg distributed load. The angle (designated " α " in figure 1) between the back section and the flat section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to $1\frac{1}{2}''$. The angle (designated " β " in figure 1) between the flat section and foot section for various configurations of the mattress support platform shall be $\pm 3^\circ$, which translates to a tolerance of up to $\frac{3}{4}''$. Any adjustable foundation deemed to be within these allocated tolerances is considered to have met the manufacturer's quality control standards.

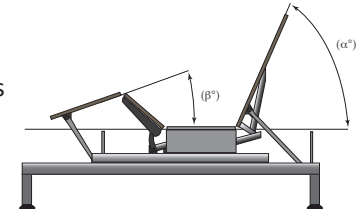

THAT "NEW PRODUCT" SMELL:

Some people notice a slight odor to their new adjustable base—this can come from our material manufacturing process. This smell is normal and usually disappears before the product reaches you. Sometimes, however, this smell may still be noticeable. It usually disappears after a few weeks, providing adequate ventilation of the product and the environment.

Safety Precautions and Usage Statements

BREAK IN PERIOD:

You can speed up the break-in period by simply spending time in the adjustable bed through activities such as reading, watching TV or playing with the kids or grandkids. The extra movement will help the adjustable base respond to weight and temperature changes. Some of the materials in our adjustable bases such as the woods, metals and plastics used in the platform, frame and components are sensitive to moisture content and temperature and may make sounds in colder environments.

PAIRED OPERATION:

When operating a “paired” split base setup there may be a time latency up to 1.5 seconds between each bases articulation.

WEAR AND TEAR:

Wear and tear is damage that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.

FABRIC CARE:

To prolong the life of your fabric, protect from direct sunlight whenever possible. For spot cleaning, wipe area with a light damp sponge or vacuum with a soft brush attachment to remove particles. Keep at a minimum of 30 cm (12 inches) away from direct heat sources. For a deeper cleaning, blot liquid spills with a clean dry cloth. Wipe with a clean cloth dampened with warm water. Do not wet excessively. A soft bristle brush may be used to remove ingrained soil. Avoid scratching by gentle brushing. Wipe with a clean cloth dampened with warm water to remove residues. Dry in shade away from direct heat. If persistent marks remain visible after cleaning, seek professional advice.

PRODUCT RATINGS:

The lift motors are not designed to operate continuously for more than [2] minutes in an [18] minute time period or approximately 10% duty cycle. Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty. The massage motors are not designed to operate continuously for more than 30 minutes at a time. Please allow the massaging system to rest for 30 minutes after automatic massage shut off before restarting.

WEIGHT LIMITS:

This product is not rated to support weights in excess of 750 pounds. The base will structurally support this weight, provided it is evenly distributed across the bed base. The adjustable base is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. Exceeding this weight restriction could damage the bed and/or cause injury and will void the warranty.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

FCC Compliance:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Parts List

Before discarding the packing materials - ensure all the parts are accounted for.

All electronics and components that need to be installed are located in boxes under the base or attached to the frame.

- A) Wireless Remote Control (1)
- B) Mattress Retainer Bar (1)*
- C) Legs (4)
- D) Power Cord (1)
- E) Power Supply (1)
- F) Sync Cord ‡
- G) Battery Backup Strap (1)
- (2) 9V Alkaline Batteries (not included)
- H) Offline Voice Control Puck with Wireless Charger
- I) Connecting Strap‡

Headboard Bracket Components (Optional):

- J) Headboard Bracket (2)†
- K) T-Bracket (2)†
- L) Long Bolts (8)†
- M) Short Bolts (6)†
- N) Wingnuts (2)†
- O) Washers (2)†
- P) Hex Key (1)†


Recommended parts not included:

Surge Protector

* These items are attached to the base for shipping purposes. Carefully remove from base and set aside.



‡ Only included in Twin Long and Cal King Split bases.

† This is an optional item and can be purchased (1-888-550-3746)

A) 	B)* 	C) 
D) 	E) 	F) ‡ 
G) 	H) 	I) ‡ 

HEADBOARD BRACKET COMPONENTS (Optional)			
J)† 	K)† 	L)† 	
M)† 	N)† 	O)† 	P)† 


Base and Remote Overview

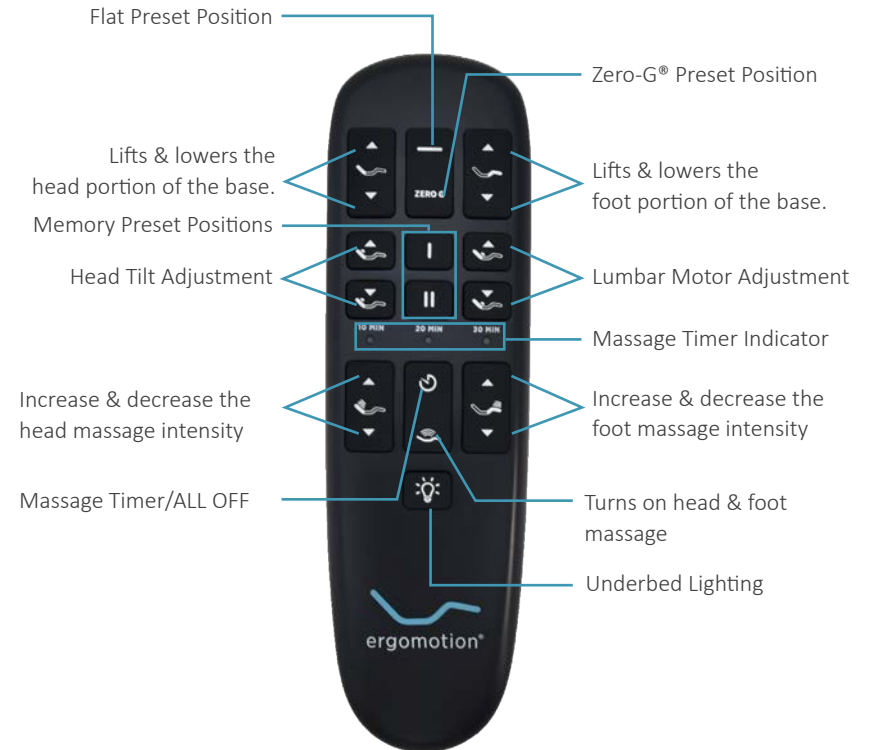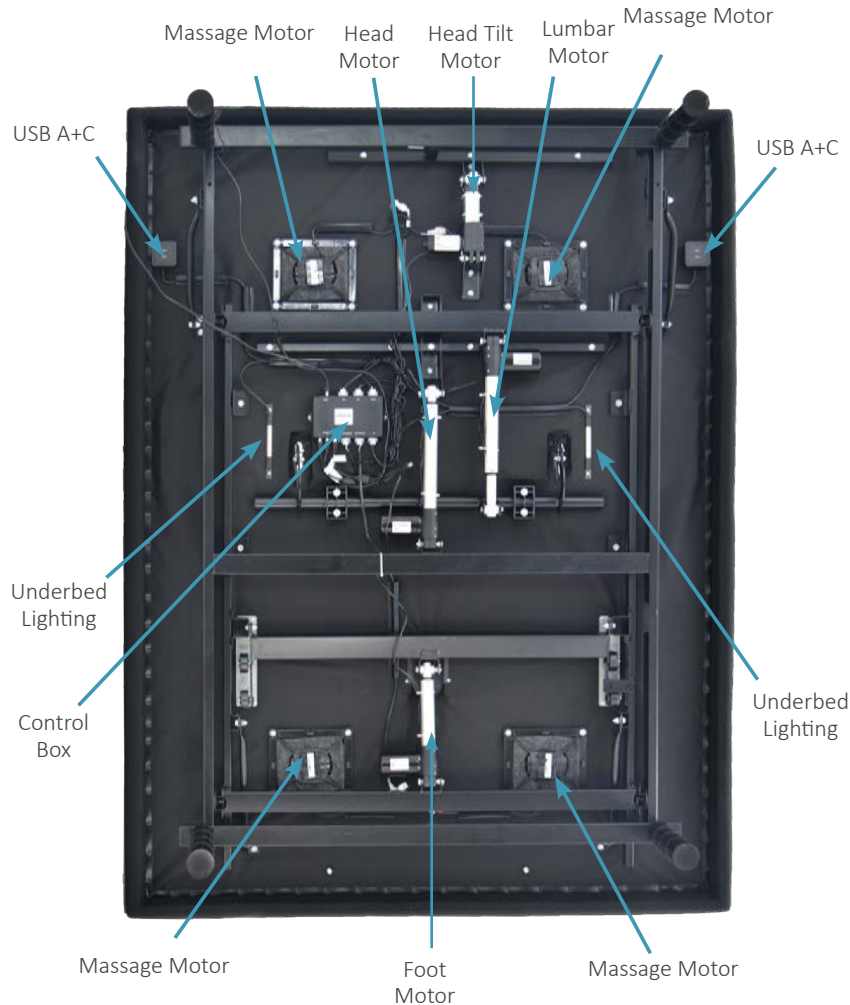

Quick Reference Guide

Not to scale. For illustration purposes only. Read all instructions before beginning installation.

ELECTRONICS OVERVIEW

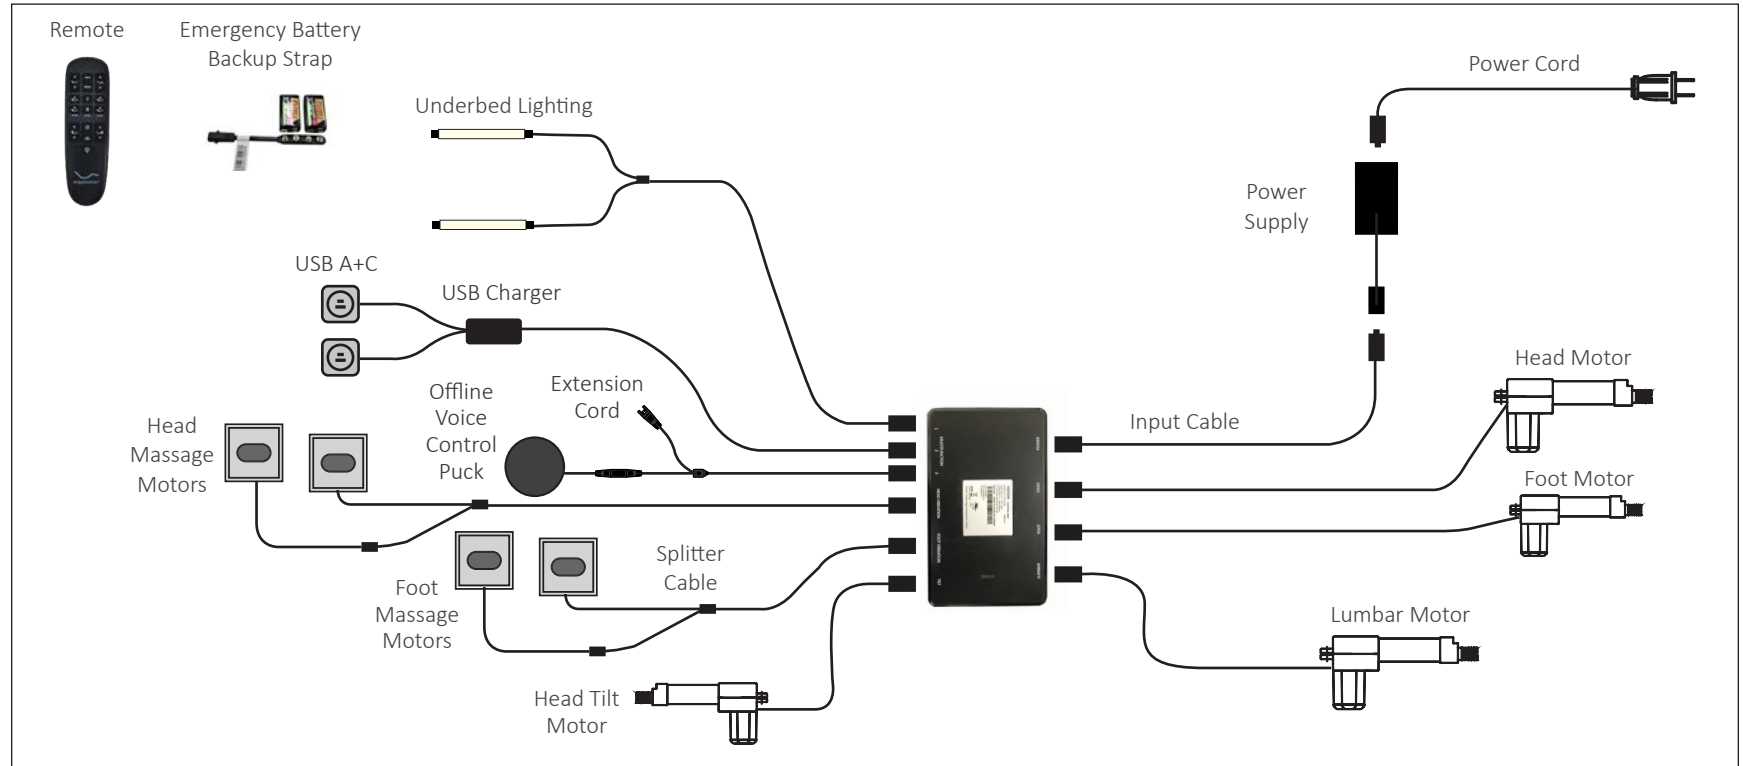

If installing a split unit, see pages 15-16.

Installation Guide

Always use two people when setting up the base.

1 Remove the bed base from the box keeping the bottom of the base facing upwards.

- Untwist the mattress retainer bar from the frame and set aside.
- Legs are shipped fully assembled. Alternative heights in 3" increments can be achieved by removing leg segments.
- To install the legs, thread the washer over the bolt of the leg with the recessed side facing the leg, and tighten by hand. **Do not over tighten.**



2 Flip the base & connect the cables.

- Uncoil the Input Cord (connected to control box's Power port) and plug it into the Power Supply.
- Carefully flip the base over on to its legs. Important: Two people are required to move the bed base. Do not drag across the floor. Do not rest frame on its side, excessive pressure may damage the legs.
- Insert the Power Cord into the Power Supply.
- Plug the Power Cord into a power outlet. **A surge protector is recommended.**



Installation Guide

3 Test remote functions & install mattress retainer bar.

- Place each end of the mattress retainer bar into the inserts at the foot of the base until the retainer bar is secured in place.



- Quickly test remote functions to verify proper setup and return the base to a flat position before placing the mattress on top.

4 Setup the Offline Voice Control Puck with Wireless Charger.

- Follow the instructions on the following pages to setup the Offline Voice Control Puck with Wireless Charger device and start controlling your base with voice commands.



Offline Voice Control Puck with Wireless Charger

Setup the puck to enable offline voice control of your adjustable base.


ATTENTION: Your adjustable base can pose an entrapment hazard which is increased in households with small children and or pets. Using voice controls further increases this entrapment hazard due to the potential of unintentionally triggering a command vocally. The voice controls could be unintentionally triggered by yourself, a small child, the television, a radio program, etc. and by using this product you agree that you have read and reviewed the commands, including the Emergency Commands, and acknowledge the increased entrapment risk associated with using voice commands.

If you agree with this statement please read the instructions on the following pages to learn how to setup the Offline Voice Control Puck, however if you have any questions in regard to the use of voice controls please contact customer service prior to activating the Offline Voice Control Puck.

WIRELESS CHARGER

- **Intro:** This item has a wireless charging function. The maximum charging power is 10W. Place the device to be charged in the center of the wireless charger. During normal operation, the green light will indicate that it is charging.
- **Overheat Protection:** In a high temperature environment, when the internal temperature of the product rises to 158 degrees (F), the wireless charger will enter a protection mode and the product will turn off the wireless charging function. When the internal temperature lowers to below 122 degrees (F), the charging function will resume.
- **Incompatible Device Detection:** If an incompatible device is placed on the charger, the red light will indicate that the device should be removed.

OVERVIEW

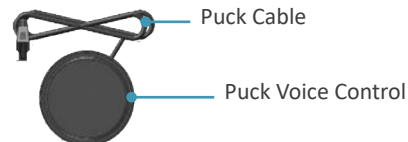

SAFETY INFORMATION

- If you wish to stop using voice commands, you can turn the device off by switching the slider on the back of the Offline Voice Control Puck to the middle "OFF" position.
- Your adjustable base can pose an entrapment hazard and there is an increased risk for households with small children and or pets. Using voice controls increases this entrapment hazard due to the potential of accidentally triggering a command vocally. The voice controls could be unintentionally triggered by a small child, television, radio program, etc., please read the "Emergency Commands" section so that you are familiar with these commands in the event of an emergency.

ENTRAPMENT HAZARD: This bed can crush and kill when it moves. Using voice controls may increase this risk. Review emergency commands before activating voice controls.

	VOICE COMMAND	EXPLANATION
 EMERGENCY COMMANDS	STOP-MOVING	Stop all movement
	ALL-UP	Raise both the head & Foot 6 seconds

Offline Voice Control Puck with Wireless Charger

Follow the installation steps below to setup the puck device.

Step 1

Please take a minute to familiarize yourself with the voice commands listed on the next page.

Step 2

Remove The Puck from the box.

Step 3

Use the remote control to lift the HEAD to the maximum angle.



Step 4

Locate the connector secured to the corner of the frame and connect it with the Puck Voice Control plug as shown in the picture.



Step 5

The Puck Voice Control will arrive in the Off position and you will need to activate the Puck by selecting an invocation command of your preference.

Use the slider switch on the back side of the Puck to select the invocation phrase you wish to use, either **“HELLO ERGO”** or **“HELLO MOTION”**. Use the bottom slider switch to select your preferred language for giving voice commands.



Note: If you have a split base, each side must have a different invocation phrase in order to work independently.

WAKE UP DEVICE

To use the Puck Voice Activated System, simply say the invocation command you chose during setup, either **“HELLO ERGO”** or **“HELLO MOTION”**, and wait 1-2 seconds for the microphone to activate. Once the microphone is activated, indicated by the blue light, it will be active for 8 seconds. While the microphone is active you can now use any of the voice commands listed below to control your adjustable base. If no command is heard within 8 seconds, the Puck will enter “sleep mode” and the microphone will be deactivated.

Offline Voice Control Puck Voice Commands

Once the invocation phrase has been uttered, the microphone will be active for 8 seconds which is indicated by the blue light. While the microphone is active you can now use any of the command utterances listed below to control your adjustable base.

	VOICES COMMANDS	EXPLANATION
Common Instructions	GOOD-NIGHT	Flat bed
Actuators Control	RAISE-HEAD	Back actuator rises 3S
	LOWER-HEAD	Back actuator falls 3S
	RAISE-FOOT	Foot actuator rises 3S
	LOWER-FOOT	Foot actuator falls 3S
	RAISE-LUMBAR	Lumbar actuator rises 3S
	LOWER-LUMBAR	Lumbar actuator falls 3S
	RAISE TILT	Head actuator rises 3S
	LOWER TILT	Head actuator falls 3S
Preset	FLAT-PRESET	Flat bed
	ANTI-SNORE	Adjust the bed to the preset position for anti-snore
	TV PRESET	Adjust the bed to the preset position for watching TV
	FAVORITE-PRESET	Adjust the bed to the preset position for favorite one
	ZERO-G®/ ZERO-GRAVITY	Adjust the bed to the preset position for Zero-G®
Massage Control	TURN-ON-MASSAGE	Turn on massage driver
	TURN-OFF-MASSAGE	Turn off massage driver
Underlight Control	TURN-OFF-LIGHT	Turn off underlight
	TURN-ON-LIGHT	Turn on underlight

Remote Control

REMOTE OVERVIEW



ADJUST



The HEAD ▲ ▼ arrows lift and lower the head section of the base.



The FOOT ▲ ▼ arrows lift and lower the foot section of the base.



One touch FLAT preset position.



One touch ZERO-G® preset position. Zero-G® adjusts your legs to a higher level than your heart helping to relieve pressure off the lower back and promote circulation.

Remote Control



MOTOR FUNCTIONS



The HEAD TILT ▲ ▼ arrows will adjust the level of head support.



The LUMBAR ▲ ▼ arrows will adjust the level of lumbar support.



MEMORY PRESETS



Preset Position #1



Preset Position #2

TO PROGRAM THE PRESET POSITIONS:

Articulate the head and foot to your desired position. Next, press and hold one of the preset buttons [I, II] for 5 seconds. The position is now saved.

NOTE: To restore the preset buttons back to their original factory settings, hold **FLAT** and **ZERO-G®** simultaneously for at least 5 seconds. The original presets will be restored.

MESSAGE FUNCTIONS / LIGHTING



The HEAD MESSAGE button will turn on the head massage. Cycle through 3 massage intensities.



The FOOT MESSAGE button will turn on the foot massage. Cycle through 3 massage intensities.



The TIMER/ALL OFF button starts massage at level 2. Select a 10, 20 or 30 minute message interval. Pressing a fourth time will turn off massage.



The lights in the centre of the remote indicate a 10, 20 or 30 minute timer setting. Massage will automatically shut off after 10 minutes if the massage timer isn't set.



The MASSAGE button turns on the head and foot massage.



Press once to activate Underbed Lighting. Press again to turn off.


Remote Control Pairing & Child Lock

Remote Control Pairing

The original remote that comes in the box is already paired to the adjustable base. No further action is required. In the event that the remote is not paired with the base, follow the steps below.

1

Unplug the Power Cord from your power outlet. Wait 1 minute, then plug it back in to your power outlet. Perform Step 2 within 10 seconds, while the control box light is flashing.

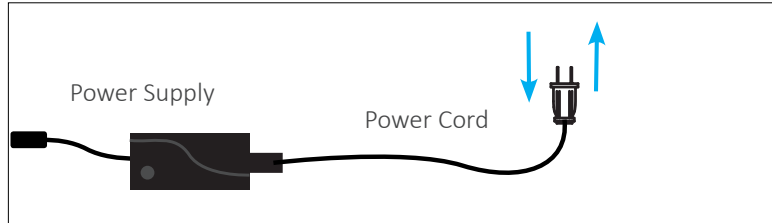

2

Press and hold down the **Head Up** and **Foot Down** buttons simultaneously. The LED light on the remote will start flashing. When the LED stops flashing, the illuminated light on the Control Box will go out. Release the **Head Up** and **Foot Down** buttons. The remote is now paired to the adjustable base.



3

Test all remote functions. If the remote buttons do not impact the adjustable base movements, please repeat the process again or call Ergomotion customer service: 1-888-550-3746

Child Safety Lock

This remote control is programmed with a child lock safety feature. Follow the instructions below to lock or unlock the remote control.

ACTIVATE CHILD LOCK

Press and hold **FLAT** and **HEAD UP** buttons for three (3) seconds. When the backlight on the remote flashes twice, the lock is completed. If any button is pressed while under the lock status, the backlight on the remote will flash twice.

DEACTIVATE CHILD LOCK

Press and hold **FLAT** and **FOOT UP** buttons together for three (3) seconds. When the backlight on the remote flashes twice, the unlock is completed and the remote will work normally.

Connecting Strap (Optional)

If a split setup is being installed, a plastic connecting straps can be used to help secure the bases together. A connecting strap is included with Twin Long and Cal King Split bases.

1

With the bases in their desired location, slightly loosen both legs to allow the strap to fit on the leg bolt, between the leg washer and frame.



3

Re-tighten legs. Do not over tighten. Use the remaining strap and repeat on other end of the base.

2

Slide side (a) of the connecting strap onto leg bolt. Swing the strap and connect side (b) to the leg bolt. Secure the strap by shifting to the left.



Syncing Two Bases (Optional)

A Sync Cord is included with the base. Not available on Queen, Full or Full-Long size bases.

The Sync Cord connects the two control boxes to a single remote for the synchronization of two bases.

This process is most commonly used for syncing two connected TXL bases.


1 _____
Unplug bases from power source.

2 _____
Connect the Sync Cord to the Multifunction port of each Control Box.

3 _____
Plug bases back into the power source.

4 _____
Check to ensure all cords are securely attached. Both remotes will now operate both bases simultaneously.

The system is now linked. Pressed buttons on either remote will control the two bases simultaneously.

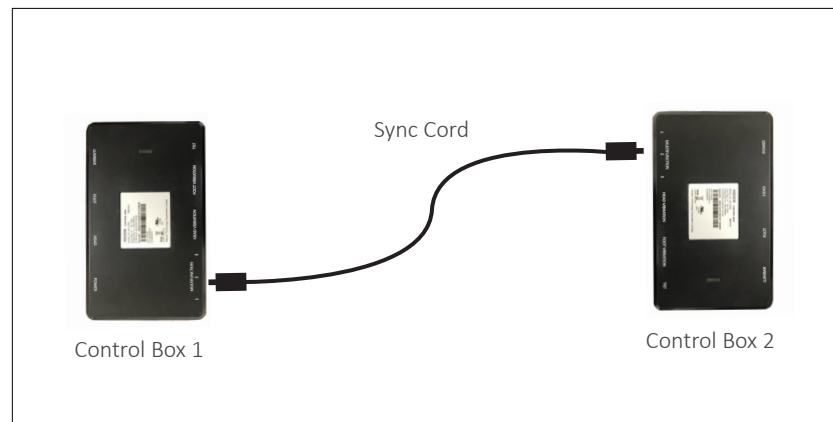

PERFORMANCE NOTES

If bases become mismatched, returning the bases to the flat positions will resync the mechanical positions.

Headboard Bracket Installation Guide (Optional)

Headboard brackets are an optional accessory.

A hex key is included with the accessory kit to complete installation.



1

- a. Align the hole in the bracket to the brass sleeve into which the leg threads. Hold the bracket in place and screw the leg into the base until it is snug. DO NOT OVERTIGHTEN. Too much force may cause the leg to spin freely.
- b. Align the tab with the hole in the frame (located towards the foot of the base) and use a short bolt, washer and wingnut to secure the bracket. Make sure the bolt is tight.



2

- a. Measure the distance between the mounting holes on the headboard and install the T-Bracket to accommodate the headboard.
- b. To install the T-Bracket, slide the T-Bracket through the end of the headboard bracket. Align the flat side of the T-Bracket plate to the mounting holes on the headboard.
- c. Secure T-Bracket in place by inserting two short screws through top of bracket. Use hex key to tighten screws.

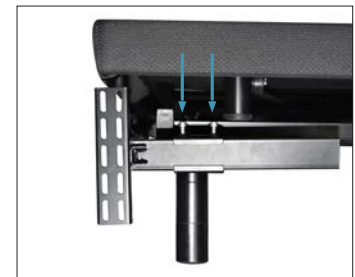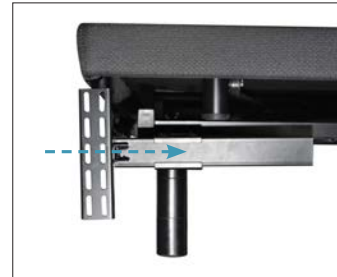

3

- Connect your headboard to the attachment plate using the remaining long screws or hardware that came with your headboard. The heads of the bolts will face outward. Use hex key to tighten bolts.


Emergency Battery Backup Strap

For emergency use only, in case of a power outage.

Batteries are not to be used for normal operation of the bed.


1

Disconnect the Power Supply from the input power cord.

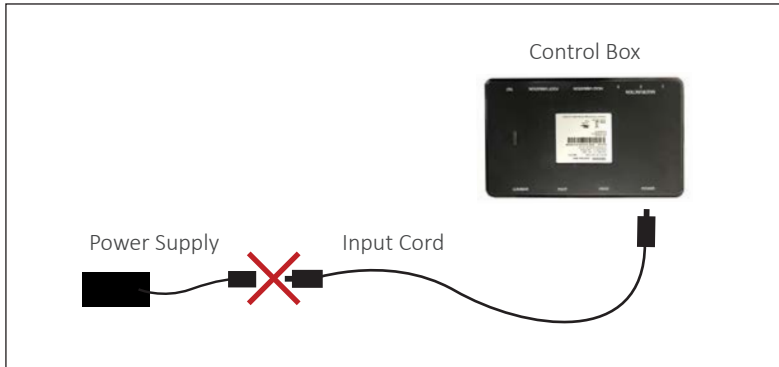

3

Connect the end of the Battery Backup Strap to the input power cord that is attached to the control box.

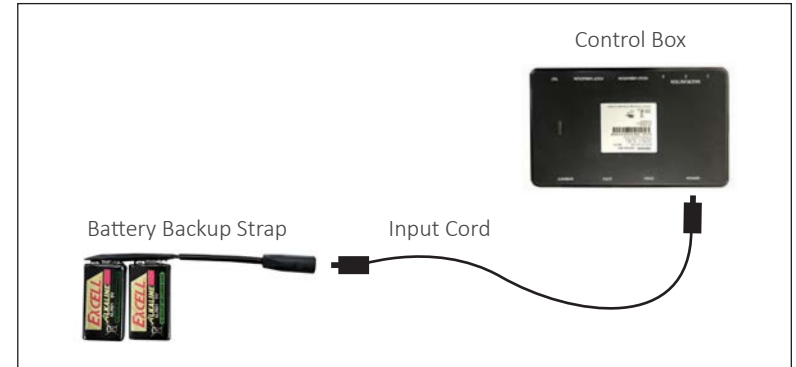

2

Connect the Battery Backup Strap to the (2) Alkaline 9 Volt batteries. Do not mix brand name Batteries.



4

Use the remote to return the base to a flat position.

Note: Detach the Battery Backup Strap and reconnect the power supply after the emergency is over, as the system will continue to draw power from the batteries even if not in use.

Troubleshooting

If one or more functions on the bed base have stopped operating:

- Check under the bed base to verify that the wired connections are secure and that there are no cords or bedding obstructing the movement of the base.
- Check to ensure the green LED light is illuminated on the control box. If there is no light, verify that the input and power cords are properly connected.
- Unplug the base for 1 minute to reset the electronic components.
- Ensure Child Lock feature is not enabled. See page 14 for more information.
- Plug bed base into a different electrical outlet, or test current outlet with another working appliance (a grounded, electrical surge protector is recommended).

If issue is not resolved by following the instructions above, locate serial number on warranty card or back of remote and call

Ergomotion Customer Service: US 1-888-550-3746

Nationwide Customer Service

©2022 Ergomotion Inc
V002_11/2022

Phone 1.888.550.3746
Fax 1.805.979.9399
Email info@ergomotion.com
Web www.ergomotion.com

Serial Number:

+	+
+	+

Consignes de sécurité et d'utilisation

Attention : Remarques importantes relatives à la sécurité

Lisez les informations suivantes avant d'utiliser ce produit. Le fait de ne pas utiliser un parasurtenseur peut compromettre la sécurité ou entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie en ce qui concerne la partie électrique.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE :

Pour optimiser la sécurité et l'efficacité, branchez la base ajustable sur un parasurtenseur (non fourni). La base ajustable ne doit être branchée qu'à une prise murale ou à un parasurtenseur (fortement recommandé). Débranchez toujours la base ajustable de la prise électrique avant de procéder à l'entretien de toute pièce qu'elle comporte. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez la base ajustable avant de la nettoyer. Pour la déconnecter en toute sécurité, assurez-vous qu'elle est à plat avec tous les moteurs éteints et débranchez-la de la source d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. Cessez d'utiliser la base ajustable et contactez un centre de dépannage qualifié si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'ils ne fonctionnent pas correctement ou s'ils ont été immergés dans de l'eau. N'utilisez cette base ajustable que dans le cadre de l'utilisation prévue décrite dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. Une surveillance constante est requise lorsque le lit ajustable est utilisé par ou près d'enfants, de convalescents, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques. Une mauvaise connexion de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique, d'incendie électrique ou un mauvais fonctionnement de ce lit. Si la fiche n'est pas adaptée à votre prise, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adaptée. Toute modification non autorisée ou le fait de ne pas utiliser une prise murale ou un parasurtenseur peut annuler la garantie en ce qui concerne la partie électrique.

ENFANTS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE :

Jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage, car ils peuvent entraîner un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, il est déconseillé aux enfants et aux petits animaux de compagnie de jouer sur ou sous le lit. Les enfants ne doivent pas utiliser la base ajustable sans la surveillance d'un adulte.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ :

Fonctionnement manuel – Si quelque chose se coince dans la plateforme lorsqu'elle est à plat, il est possible de la relever manuellement en la soulevant au niveau de la tête ou du pied pour relâcher la pression et la décoincer.

Arrêt d'urgence – Interrompt les mouvements de la plateforme en appuyant sur n'importe quel bouton de la télécommande.

Coupure de courant – Utilisez la sangle pour piles de secours comme source d'alimentation temporaire pour amener le lit ajustable à la position souhaitée. Les instructions d'utilisation de la sangle pour piles de secours se trouvent sur la page décrivant cet accessoire.

Verrouillage pour enfant - Cette télécommande est programmée avec une fonction de sécurité de verrouillage pour enfants. Des informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction se trouvent sur les pages Télécommande.

STIMULATEURS CARDIAQUES :

Certains produits contiennent des AIMANTS en néodyme qui peuvent interférer avec des appareils tels que les stimulateurs cardiaques, les DAI et tout autre appareil sensible aux champs magnétiques. Il est **FORTEMENT** recommandé aux utilisateurs de ces dispositifs médicaux de consulter leur médecin avant d'utiliser des produits qui contiennent des AIMANTS en néodyme. Il est également possible que certains stimulateurs cardiaques interprètent à tort les vibrations de la fonction de massage facultative comme un mouvement ou un exercice. Il s'agit d'une situation fréquente avec tout produit qui crée un mouvement vibrant et qui peut affecter un stimulateur cardiaque. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la fonction de massage.

UTILISATION À DOMICILE ET NORMES HOSPITALIÈRES :

Les bases ajustables Ergo sont conçues uniquement pour une utilisation à domicile. Ce lit ajustable n'a pas été conçu comme un lit d'hôpital et n'est pas destiné à répondre aux normes hospitalières. N'utilisez pas ce lit avec un équipement d'oxygénothérapie de TYPE TENTE ou à proximité de gaz explosifs.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES :

Les roulettes (accessoire en option pour les pieds du lit) sont équipées de dispositifs de blocage pour éviter tout mouvement indésirable. Les roulettes peuvent glisser même lorsqu'elles sont verrouillées et qu'elles ne peuvent pas rouler. Les moteurs à dégagement libre au niveau de la tête et du pied de lit sont conçus pour abaisser le matelas en se rétractant uniquement par l'effet de la gravité, sans jamais tirer vers le bas, ce qui minimise les points de pincement.

Consignes de sécurité et d'utilisation

MÉCANISMES DE LEVAGE/ABAISSEMENT :

La fonction de levage/abaissement émet un bourdonnement minimal pendant le fonctionnement. Ce bruit est normal. Pendant le fonctionnement, les roulettes dumas de levage entrent en contact avec le support de la plateforme de la base ajustable. Ce contact peut entraîner un contact métal sur métal ou métal sur plastique. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. En cas de bruit ou de vibrations excessifs, inversez le mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base à l'aide de la télécommande. Cela devrait réaligner les mécanismes d'activation du lit ajustable sur la position opérationnelle appropriée. En fonctionnement normal, les roulettes, qui permettent au lit de maintenir sa distance par rapport au mur, entrent en contact avec les supports de plateforme en acier de la base ajustable et produisent alors un bruit. Lorsque vous entrez dans le lit, en sortez ou bougez dessus, ce bruit peut être audible lorsque les roulettes entrent en contact. Ce bruit est normal.

MATÉRIAUX :

Les lits ajustables Ergo sont fabriqués à partir de divers matériaux, dont différentes essences de bois, des métaux, des plastiques et des tissus. La tension, la pression ou le mouvement appliqué sur le châssis, la plateforme ou le cadre lors d'une utilisation normale peuvent générer un son audible.

FONCTION DE MASSAGE ET EMPLACEMENT DU LIT :

La fonction de massage émet un bruit pendant son fonctionnement. Ce bruit est normal. La tonalité s'intensifie au fur et à mesure que le niveau d'intensité du massage augmente. Le volume de ce bruit est directement lié à l'environnement où se trouve le lit.


Par exemple, lorsqu'une démonstration du fonctionnement du lit s'effectue dans un magasin, le bruit environnant couvre une partie des sons produits par le massage. Cependant, si le lit est installé dans une maison avec du parquet, avec de la moquette ou non, le volume du massage sera plus perceptible. Pour réduire cette résonance, placez un morceau de tapis, ou des patins en caoutchouc, sous chaque pied ou roulette de la base ajustable. Il est possible de ressentir des vibrations ou du bruit provenant du cadre extérieur de la base ajustable, des supports de la tête de lit, de la tête de lit ou du pied de lit si les boulons de montage ne sont pas fermement serrés. Les niveaux 1 à 3 d'intensité de massage représentent le nombre de tours du moteur par minute. Le niveau 3 indique le nombre maximum de tours par minute. Cependant, cela ne signifie pas que la sensation de vibration sera la plus forte. La sensation de vibrations sera différente en fonction du matériau du matelas, de l'épaisseur et du positionnement de l'utilisateur. Nous recommandons à l'utilisateur de déterminer le réglage d'intensité de massage qui lui convient le mieux. Il est important de

comprendre la physique des vibrations. Tout comme un moteur peut tourner irrégulièrement au ralenti, les vibrations changent dès que le régime augmente.

TOLÉRANCE :

Toutes les bases ajustables Ergo, en fonction de la marque et du modèle, sont conçues et fabriquées pour fonctionner dans les limites des paramètres de contrôle qualité désignés. Les bases font l'objet d'inspections méticuleuses et rigoureuses au cours du processus de contrôle de la qualité afin de s'assurer qu'elles fonctionneront dans le respect de ces normes pendant une utilisation normale. Une utilisation normale est définie comme suit : Le lit ajustable doit être utilisé avec un matelas et une charge. Les procédures de test font appel à des tests de cycle de vie avec une charge distribuée atteignant 120 kg (264 lb). L'angle (désigné par un « α » dans l'image) entre la section arrière et la section plate pour les différentes configurations de la plateforme de support du matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance de 1,5 po (3,7 cm) maximum.

L'angle (désigné par un « β » dans l'image) entre la section plate et la section du pied de lit pour différentes configurations de la plateforme de support du matelas doit être de $\pm 3^\circ$, ce qui se traduit par une tolérance atteignant $\frac{3}{4}$ po (1,9 cm.) Toute base ajustable jugée conforme à ces limites de tolérance est considérée comme ayant satisfait aux normes de contrôle qualité du fabricant.

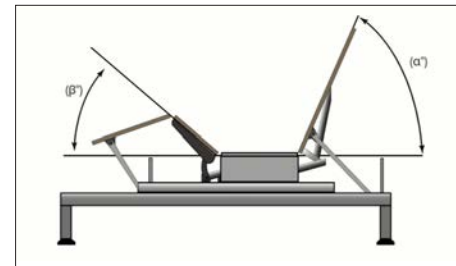

L'ODEUR DE « NOUVEAU PRODUIT » :

Certaines personnes remarquent une légère odeur se dégageant de leur nouvelle base ajustable, ce qui peut provenir de notre processus de fabrication et des matériaux employés. Cette odeur est normale et disparaît généralement avant que le produit ne vous soit livré. Parfois, cependant, cette odeur peut encore être perceptible. Elle disparaît généralement après quelques semaines, sous réserve qu'il y ait une ventilation adéquate du produit et de l'environnement.

PÉRIODE DE RODAGE :

Vous pouvez accélérer la période de rodage en passant simplement du temps dans le lit ajustable en lisant, en regardant la télévision ou en jouant avec vos

Consignes de sécurité et d'utilisation

enfants ou petits-enfants. Ces mouvements supplémentaires aideront la base ajustable à répondre aux changements de poids et de température. Certains des matériaux de nos lits ajustables, tels que les essences de bois, les métaux et les plastiques utilisés dans la plateforme, le cadre et les composants, sont sensibles à l'humidité et à la température et peuvent produire des sons dans des environnements plus froids.

UTILISATION DE 2 LITS SYNCHRONISÉS :

Lors de l'utilisation de lits ajustables synchronisés, il peut y avoir un intervalle allant jusqu'à 1,5 secondes entre les mouvements de chaque lit.

USURE NORMALE :

L'usure normale correspond au dommage qui se produit naturellement et inévitablement à la suite d'une utilisation normale ou du vieillissement du lit ajustable.

ENTRETIEN DU TISSU :

Protégez le tissu de la lumière directe du soleil chaque fois que c'est possible afin d'en prolonger la durée de vie. Pour le nettoyage des taches, essuyez la zone avec une éponge légèrement humide ou passez un aspirateur avec une brosse douce pour éliminer les particules. Maintenez les parties en tissu au moins à 12 pouces (30 cm) de sources de chaleur directes. Pour un nettoyage plus en profondeur, épongez les liquides avec un chiffon propre et sec. Essuyez avec un chiffon propre imbibé d'eau tiède. Ne pas mouiller excessivement. Une brosse à poils doux peut être utilisée pour enlever la saleté incrustée. Évitez de rayer la surface en brossant délicatement. Essuyez avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau tiède pour éliminer les résidus. Séchez à l'ombre loin d'une source directe de chaleur. Consultez un professionnel si des marques persistantes restent visibles après le nettoyage.

CLASSIFICATION DU PRODUIT :

Les moteurs de levage ne sont pas conçus pour fonctionner en continu pendant plus de [2] minutes sur une période de [18] minutes, ou environ 10 % du cycle de fonctionnement. Tenter de contourner ou dépasser cette valeur peut réduire la durée de vie du produit et annuler la garantie. Les moteurs de relaxation ne sont pas conçus pour opérer de manière continue durant plus de 30 minutes à la fois. Veuillez laisser le système de relaxation inactif pendant 30 minutes après son arrêt automatique avant de le redémarrer.

LIMITES DE POIDS :

Ce produit n'est pas conçu pour supporter plus de 750 livres (340 kg). Ces limites comprennent le poids du matelas et de la literie. Le lit ajustable soutiendra structurellement ce poids, à condition qu'il soit uniformément réparti sur toute sa surface. Le lit ajustable n'est pas conçu pour supporter ou soulever de tels poids au niveau de la tête ou du pied de lit seulement. Le dépassement de cette limite de poids annulerait la garantie, pourrait endommager le lit et/ou causer des blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Conformité FCC:

Cet appareil a été testé et jugé conforme à la section 15 des règles de la FCC pour un appareil digital de classe B. Ces limites assurent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que de l'interférence ne surviendra pas dans certains cas. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception d'un téléviseur ou d'une radio, ce qui peut être prouvé en débranchant et rebranchant cet équipement, l'utilisateur peut utiliser l'une ou plusieurs des méthodes de correction suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- brancher l'équipement dans un circuit électrique différent de celui du récepteur
- consulter le vendeur ou un technicien radio/télévision d'expérience.

Liste des pièces

Avant de disposer de l'emballage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces en votre possession.

Toutes les composantes, électroniques et autres, devant être installées sont attachées sous le lit, ou se trouvent dans des boîtes sous le lit.

- A) Télécommande (1)
- B) Barre de soutien du matelas (1) *
- C) Pattes (4)
- D) Câble d'alimentation électrique (1)
- E) Bloc d'alimentation électrique (1)
- F) Câble de synchronisation ‡
- G) Courroie pour les piles (1)
- piles 9V (non comprises)
- H) Rondelle de commandes vocales / chargeur sans fil
- I) Sangle de raccordement ‡

Composantes des équerres pour têtes de lit (en option):

- J) Équerres de têtes de lit (2) †
- K) Équerres en T (2) †
- L) Boulons longs (8)†
- M) Boulons courts (6)†
- N) Papillons (2)†
- O) Rondelles (2)†
- P) Clé hexagonale (1)†


Pièce recommandée (non inclus) :

Parasurtenseur

* Cet item est attaché sous le lit pour le transport. Retirez et mettre de côté.

‡ Disponibles seulement pour les lits une place extra-long, et les très grands lits séparés de type California



† Cette pièce est en option et peut-être achetée séparément (1-844-534-3676)

A) 	B)* 	C) 
D) 	E) 	F) ‡ 
G) 	H) 	I) ‡ 

COMPOSANTES DES ÉQUERRES POUR TÊTES DE LIT (EN OPTION)

J)† 	K)† 	L)† 
M)† 	N)† 	O)† 
	P)† 	


Vue d'ensemble : lit et télécommande

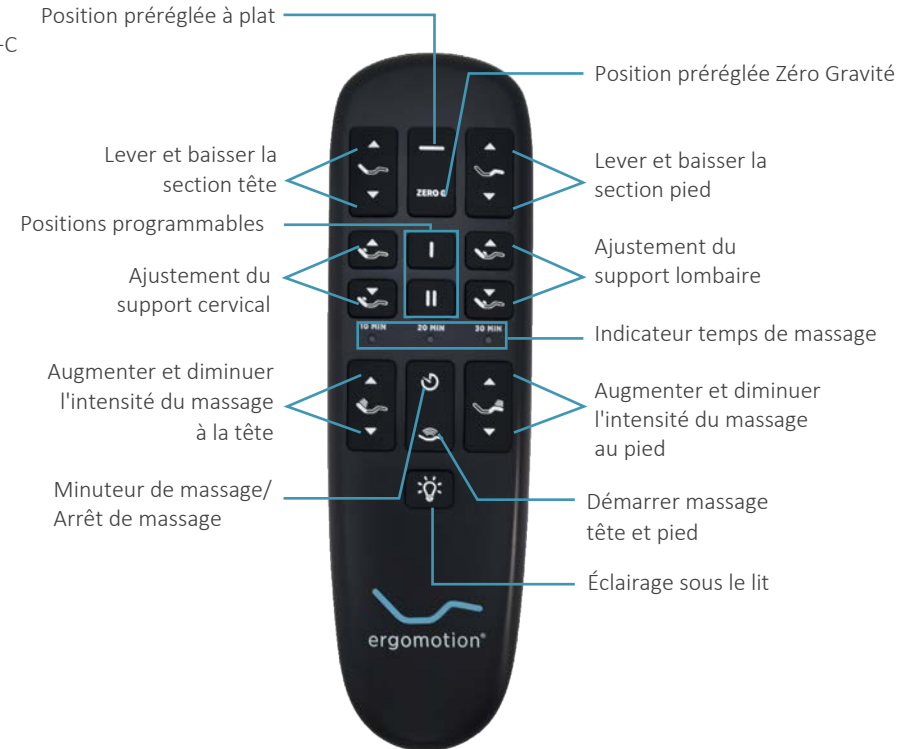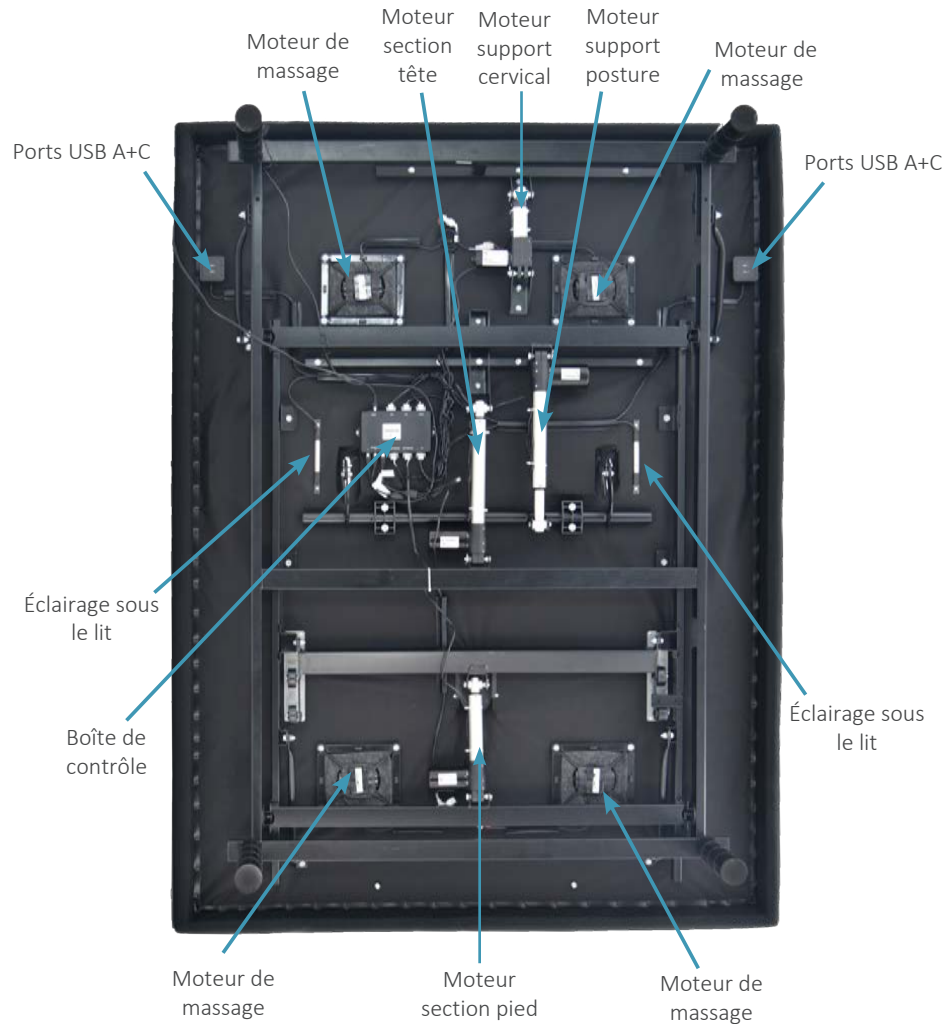

Guide de référence rapide

Pas à l'échelle. À titre d'illustration seulement. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.

APERÇU DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

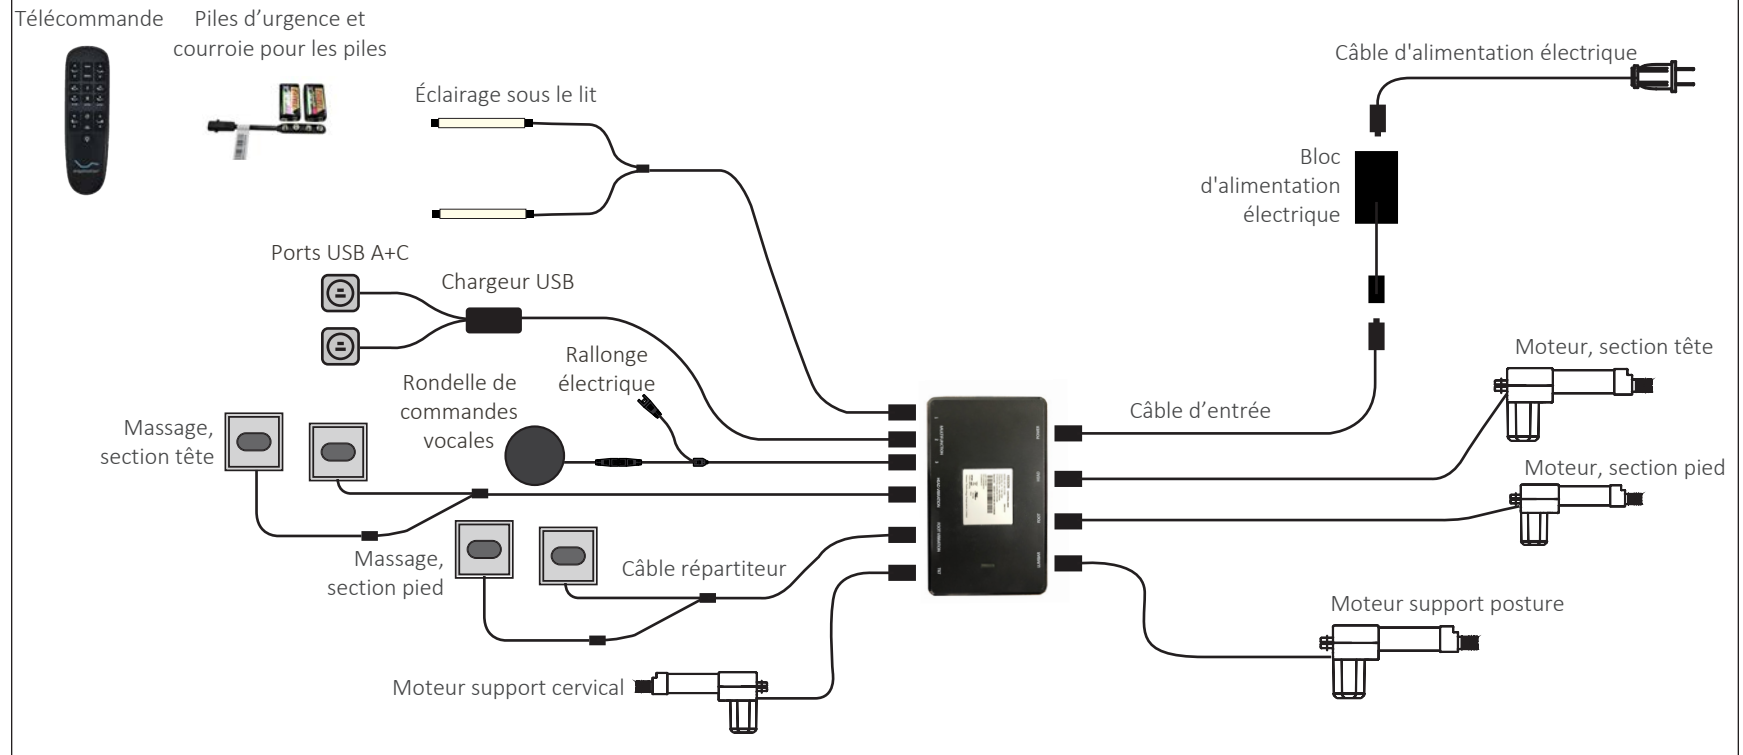

Pour l'installation de deux lits, voir pages 35-36.

Guide d'installation

Le lit doit toujours être déplacé, ou retourné par deux personnes.

1

Retirez la base de la boîte en gardant le dessous de la base vers le haut.

- Prendre la barre de soutien du matelas attachée au lit et la mettre de côté.
- Les pattes sont livrées prêtes à être installées. On peut ajuster le lit à 4 hauteurs différentes en dévissant les sections de chaque pattes.
- Pour installer les pattes, placez une rondelle sur la partie filetée de chaque patte, la partie arrondie vers la patte. Introduire la patte dans son emplacement et visser. **Ne pas trop serrer.**



2

Retournez la base et branchez les câbles.

- Déroulez le câble connecté au port d'alimentation sur la boîte de contrôle, et branchez-le dans le bloc d'alimentation électrique.
- Retournez soigneusement le lit sur ses pattes. Important: il faut deux personnes pour déplacer ou retourner le lit. Ne pas trainer le lit sur le sol. Ne pas déposer le lit sur son côté, la pression excessive sur les pattes pourrait les endommager.



- Branchez le câble d'alimentation électrique dans le bloc d'alimentation électrique.



- Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique.
L'utilisation d'un parasurtenseur est recommandée.



3 Essayez les fonctions de la télécommande et installez la barre de soutien du matelas.

- Insérez les extrémités de la barre de soutien du matelas dans les ancrages prévus à cet effet au pied du lit.



- Essayez les fonctions de la télécommande pour s'assurer que sa configuration est appropriée, et ramenez le lit en position à plat avant d'y déposer le matelas.

4 Configurez la rondelle de commandes vocales / chargeur sans fil.

- Suivez les instructions des pages suivantes pour configurer la rondelle de commandes vocales avec chargeur sans fil et contrôlez votre lit ajustable grâce aux commandes vocales, et ce, sans connexion internet.



Rondelle de commandes vocales / chargeur sans fil

Configurez la rondelle pour activer le contrôle vocal de votre lit ajustable.


ATTENTION : Votre lit ajustable peut présenter un risque qu'on s'y retrouve bloqué, en particulier dans les foyers avec de jeunes enfants et/ou des animaux domestiques. L'utilisation des contrôles vocaux augmente ce risque, les commandes pouvant être actionnées involontairement, que ce soit par vous, un enfant, la télévision, la radio, etc. Par votre utilisation de ce produit vous acceptez avoir lu et essayé les commandes, incluant les commandes d'urgence, et reconnaissez ce risque d'entrave associé avec l'usage des commandes vocales.

Si vous êtes d'accord avec cet énoncé, veuillez lire les instructions aux pages suivantes afin d'apprendre comment configurer la rondelle de commandes vocales. Toutefois, si vous avez des questions concernant l'utilisation des contrôles vocaux, veuillez contacter le service à la clientèle avant d'activer la rondelle de commandes vocales.

CHARGEUR SANS FIL

- **Introduction :** La rondelle a une fonction de recharge sans fil. La puissance de charge maximale est de 10W. Placez l'appareil à recharger dans le centre du chargeur sans fil. Pendant le chargement, la lumière verte indiquera que l'appareil est en train de charger.
- **Protection contre la surchauffe :** Dans un environnement à température élevée, le chargeur sans fil entrera en mode protection et arrêtera la mise en charge lorsque sa température interne atteint 70°C (158°F). La mise en charge reprend dès que la température interne retourne à en-dessous de 50°C (122°F).
- **Détection d'appareil incompatible :** Si un appareil incompatible est placé sur le chargeur, une lumière rouge s'allume pour indiquer de retirer l'appareil.

APERÇU

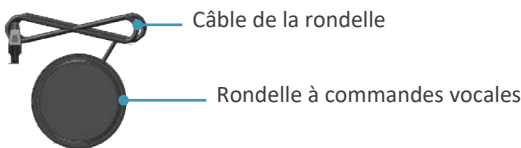

INFORMATION DE SÉCURITÉ

- Si vous désirez arrêter l'utilisation des commandes vocales, vous pouvez éteindre la rondelle de commandes vocales en mettant l'interrupteur, situé sous l'appareil, sur la position « OFF ».
- Votre lit ajustable peut présenter un risque qu'on s'y retrouve bloqué, et le risque est plus élevé dans les foyers avec de jeunes enfants et/ou des animaux domestiques. L'utilisation des contrôles vocaux augmente ce risque, les commandes pouvant être actionnées involontairement, que ce soit par vous, un enfant, la télévision, la radio, etc. S.V.P. bien lire la section des "Commandes en cas d'urgence" afin que vous soyez familier avec ces dernières en cas d'urgence.

RISQUE D'ÊTRE BLOQUÉ : Ce lit peut écraser et tuer lorsqu'en mouvement. Utiliser les commandes vocales peut augmenter ce risque. Revoir les commandes en cas d'urgence avant d'activer les commandes vocales.

	COMMANDES VOCALES	EXPLICATIONS
 COMMANDES D'URGENCE	STOP	Arrête tous mouvements
	TOUT EN HAUT	Soulève la tête et le pied durant 6 secondes

Rondelle de commandes vocales / chargeur sans fil

Suivre les étapes suivantes pour configurer la rondelle.

Étape 1

Prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les commandes vocales listées à la page 31.

Étape 2

Sortir la rondelle de la boîte.

Étape 3

Utiliser la télécommande pour lever la tête à l'angle maximum.



Étape 4

Localiser le connecteur fixé au coin du cadre et le brancher à la prise de la rondelle de commandes vocales tel qu'indiqué sur l'image.



Étape 5

Le commutateur d'activation de la rondelle de commandes vocales arrive par défaut sur la position « OFF ». Pour la mettre en fonction, vous devrez choisir une commande d'activation.



Utilisez le commutateur situé à l'arrière de la rondelle pour sélectionner la phrase d'activation que vous souhaitez utiliser, soit « **ALLO ERGO** » ou « **ALLO MOTION** ». Utilisez ensuite le commutateur inférieur pour sélectionner la langue de votre choix.

Note : Si vous avez deux bases séparées, chaque base doit avoir une commande d'activation différente afin de les faire fonctionner séparément.

ACTIVER LA RONDELLE

Afin d'utiliser la rondelle de commandes vocales, simplement dire la commande d'activation que vous avez préalablement choisie soit « **ALLO ERGO** » ou « **ALLO MOTION** », et attendre 1-2 secondes afin que le microphone s'active. Une fois le microphone activé, ce qui est indiqué par une lumière bleue, il le restera pendant 8 secondes. Pendant que le microphone est activé, vous pouvez utiliser les commandes vocales listées à la page 31 pour contrôle votre lit ajustable. Si aucune commande n'est dictée pendant les 8 secondes, la rondelle entrera en mode veille et le microphone sera désactivé.

Commandes vocales de la rondelle

Une fois que la commande d'activation a été prononcée, le microphone est actif pendant 8 secondes, ce qui est indiqué par la lumière bleue. Pendant que le microphone est activé, vous pouvez utiliser les commandes vocales listées ci-dessous pour contrôler votre lit ajustable.

	COMMANDES VOCALES	EXPLICATION
Instructions courantes	BONNE NUIT	Met le lit en position à plat
Contrôle des déclencheurs	LEVER TÊTE	La section tête s'élève durant 3 secondes
	BAISSER TÊTE	La section tête s'abaisse durant 3 secondes
	MONTER PIED	La section pied s'élève durant 3 secondes
	BAISSER PIED	La section pied s'abaisse durant 3 secondes
	LEVER SUPPORT LOMBAIRE	Le support de posture s'élève durant 3 secondes
	BAISSER SUPPORT LOMBAIRE	Le support de posture s'abaisse durant 3 secondes
	REDRESSER TÊTE	Le support cervical s'élève durant 3 secondes
	INCLINER TÊTE	Le support cervical s'abaisse durant 3 secondes
Préréglages	POSITION À PLAT	Met le lit en position à plat
	ANTI-RONFLEMENT	Ajuste le lit en position anti-ronflement
	ZERO-G®	Ajuste le lit en position Zéro gravité
	POSITION FAVORITE	Ajuste à la position favorite
	POSITION TÉLÉVISION	Ajuste à la position programmée pour regarder la télévision
Contrôle du massage	DÉMARRER MASSAGE	Actionne la fonction massage
	ARRÊTER MASSAGE	Arrête le massage
Éclairage sous le lit	FERMER LES LUMIÈRES	Éteint l'éclairage sous le lit
	ALLUMER LES LUMIÈRES	Allume l'éclairage sous le lit

Télécommande

APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE



AJUSTEMENTS



Les flèches ▼ ▲ soulèvent et baissent la section tête.



Les flèches ▲ ▼ soulèvent et baissent la section pied.



Position à plat préprogrammée.



Le bouton préréglé ZERO-G® ajuste les jambes dans une position au-dessus du cœur afin de relâcher la pression sur le bas du dos et améliorer la circulation.

Télécommande



FONCTIONS DES MOTEURS



Les flèches ▼ ▲ ajustent l'inclinaison du support cervical.



Les flèches ▼ ▲ ajustent le niveau support de posture.



POSITIONS PROGRAMMABLES



Position programmable 1



Position programmable 2

POUR PROGRAMMER LES POSITIONS PROGRAMMABLES :

Articulez les sections tête et pied dans la position désirée. Appuyez ensuite sur l'une des touches programmables [I, II], et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. La position est maintenant sauvegardée.

NOTE: Pour revenir à la position programmée à l'usine, maintenez enfoncés les boutons à plat [—] et **ZERO-G®** simultanément pendant au moins 5 secondes. Les positions par défaut seront rétablies.

FONCTIONS DE MASSAGE/ÉCLAIRAGE



Met en marche et arrête le massage à la tête. 3 niveaux d'intensité sont disponibles.



Met en marche et arrête le massage au pied. 3 niveaux d'intensité sont disponibles.



Met en marche le massage au niveau 2. Choisissez 10, 20 ou 30 minutes de massage. Appuyer une 4^e fois sur le bouton pour arrêter le massage.

10 MIN



Les lumières au centre de la télécommande indiquent la durée du massage (10, 20 ou 30 minutes). Le massage prendra automatiquement fin après 10 minutes si aucune autre durée n'a été déterminée.



Met en marche le massage à la tête et au pied.



Appuyer une fois pour activer les lumières sous le lit et appuyer une seconde fois pour les éteindre.


Synchronisation de la télécommande et verrouillage parental

Synchronisation de la télécommande

La télécommande fournie dans l'emballage est déjà synchronisée avec le lit ajustable. Aucune autre action n'est requise. Dans le cas où la télécommande n'est pas synchronisée avec le lit ajustable, suivez les instructions ci-dessous.

1

Débranchez le cordon d'alimentation électrique de votre prise. Attendez une minute, et rebranchez-le. Effectuez l'étape 2 dans les prochaines 10 secondes, pendant que le voyant de la boîte de contrôle clignote.

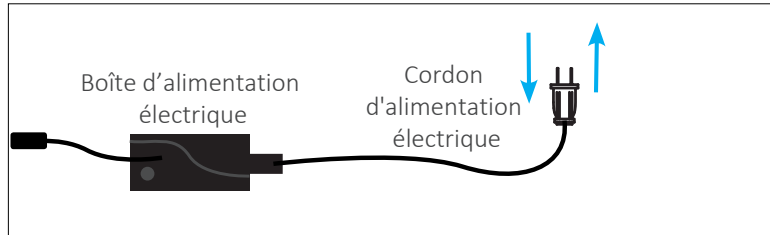

2

Appuyez et maintenez enfoncé les boutons « Relever la tête » et « Baisser le pied » simultanément. Le rétroéclairage de la télécommande commencera à clignoter. Quand ce clignotement s'arrête, la lumière de la boîte de contrôle s'éteint. Relâchez les boutons « Relever la tête » et « Baisser le pied ». La télécommande est maintenant synchronisée avec le lit ajustable.



3

Essayez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons ne fonctionnent pas, veuillez répéter les étapes 1 et 2, ou appeler le service à la clientèle chez Ergomotion au 1-888-550-3746.

Verrou de sécurité pour enfant

Cette télécommande est programmée avec une fonction de verrouillage de sécurité pour enfant. Suivez les instructions ci-dessous pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande.

ACTIVER LE VERROUILLAGE PARENTAL

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons **À PLAT** et **LEVER LA TÊTE** pendant 3 secondes. Lorsque le rétroéclairage de la télécommande clignote 2 fois, le verrouillage est complété. En mode Verrouillage parental, lorsque vous appuyez sur un bouton, le rétroéclairage de la télécommande clignotera deux fois.

DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE PARENTAL

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons **À PLAT** et **LEVER LE PIED** pendant 3 secondes. Lorsque le rétroéclairage de la télécommande clignote 2 fois, le déverrouillage est complété et la télécommande fonctionnera normalement.

Sangle de raccordement (facultatif)

Si deux lits sont installés côte à côte, on utilise les sangles de raccordement pour attacher les lits ensemble. Les sangles de raccordement sont incluses avec les lits Simples XL et les Très grands lits californiens séparés.

1

Lorsque les bases sont à leur emplacement final, dévissez légèrement les deux pattes qui seront attachées ensemble afin de permettre l'installation de la sangle sur la partie fileté de la patte, entre la rondelle et le lit.



3

Resserrez les pattes. Ne pas trop serrer. Utiliser l'autre sangle pour répéter les étapes 1 et 2 à l'autre extrémité du lit.

2

Glissez une extrémité de la sangle (a) sur la partie filetée d'une des pattes. Faites pivoter la sangle et attachez-la sur la partie filetée de l'autre patte. Fixez la sangle en la déplaçant vers la gauche.




Synchronisation de deux lits (facultatif)

Un câble de synchronisation est inclus avec le lit. Non disponible avec les formats Grand lit et deux places. Le câble de synchronisation connecte les deux boîtes de contrôle à une seule télécommande pour synchroniser deux lits. La méthode suivante est le plus souvent utilisée pour synchroniser 2 lits une place extra-long.

- 1 Débranchez les lits de la prise électrique murale.
- 2 Connectez le câble de synchronisation au port multifonction de chacune des boîtes de contrôle.
- 3 Rebranchez les lits dans la prise électrique murale.
- 4 Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés. Les deux télécommandes font maintenant fonctionner les deux lits en même temps.

Les lits sont maintenant synchronisés. Appuyez sur les boutons de n'importe quelles des télécommandes pour contrôler les deux lits simultanément.

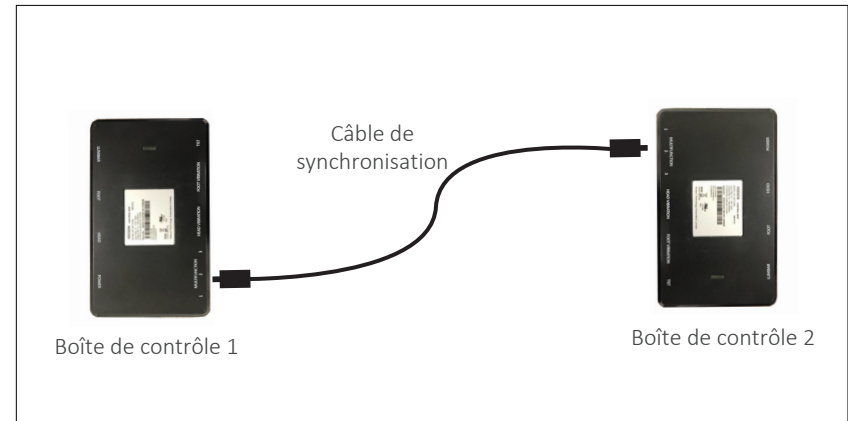

NOTES

Si les lits en viennent à être à des hauteurs différentes, ramener les lits à la position à plat pour resynchroniser les positions.

Installation des équerres de tête de lit (facultatif)

Les équerres de tête de lit sont optionnelles et ne sont donc pas incluses.


Une clé hexagonale est fournie dans le kit d'accessoires pour réaliser leur installation.

1

- a. Alignez le trou de l'équerre de tête de lit vis-à-vis la douille en laiton dans laquelle la patte est vissée. Tenez l'équerre en place et vissez la patte dans la base jusqu'à ce que la patte soit bien ajustée. Attention: la patte ne doit pas être TROP SERRÉE, sinon le filetage de la patte sera abîmé.
- b. Alignez la languette et le trou dans la base (située vers le pied de la base), utilisez un boulon court, une rondelle et un papillon pour attacher l'équerre. Assurez-vous que le boulon soit bien serré.



- a. Mesurez la distance entre les trous de montage sur la tête de lit et installez l'équerre en T de manière à pouvoir recevoir la tête de lit.
- b. Pour installer l'équerre en T, glissez-la dans l'extrémité de l'équerre de tête de lit précédemment installée à la patte. Alignez le côté plat de l'équerre en T avec les trous de montage de la tête de lit.
- c. Fixez l'équerre en T en place en insérant deux boulons courts dans le haut de l'équerre de tête de lit. Utilisez la clé hexagonale pour serrer.

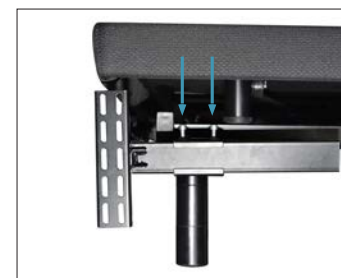

3

Installez votre tête de lit à la plaque de fixation à l'aide des boulons longs et de la quincaillerie restante fournie avec votre tête de lit. Les têtes des boulons seront tournées vers l'extérieur. Utilisez la clé hexagonale pour serrer les boulons.


Courroie pour les piles d'urgence

Pour utilisation en cas d'urgence seulement, dans le cas d'une panne de courant.

Les piles ne doivent pas être utilisées pour le contrôle normal du lit.


1

Débranchez le bloc d'alimentation électrique du câble d'entrée de la boîte de contrôle.

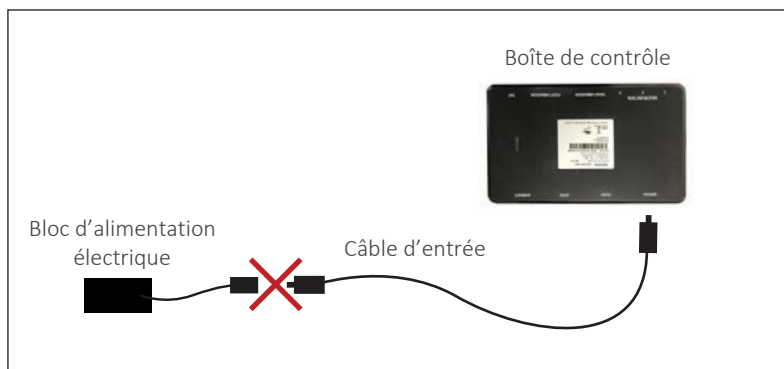

3

Branchez l'extrémité de la courroie au câble d'entrée de la boîte de contrôle.

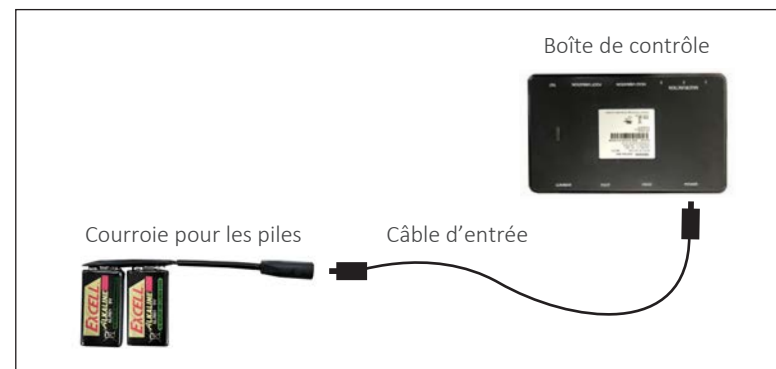

2

Connectez la courroie aux deux piles alcalines 9 volts. Utilisez des piles de la même marque.



4

Utilisez la télécommande pour retourner à la position à plat.

Note : Détachez la courroie pour piles, et rebranchez le bloc d'alimentation à la boîte de contrôle lorsque le courant est rétabli, sinon le système continuera à s'alimenter à partir des piles même s'il n'est pas utilisé.

Si une ou plusieurs fonctions ne répondent plus :

- Vérifiez sous le lit que les fils sont bien branchés et que les mouvements de la base ne sont pas entravés par des câbles ou par la literie.
- Vérifiez si la lumière DEL verte est allumée sur la boîte de contrôle. S'il n'y a pas de lumière, vérifiez le branchement de tous les câbles.
- Débranchez la base pendant 1 minute pour réinitialiser les composantes électroniques.
- Assurez-vous que le verrouillage parental n'est pas activé. Pour plus d'informations, allez à la page 34.
- Essayez de brancher la base dans une autre prise électrique, ou testez le fonctionnement de la prise avec un autre appareil (un parasurtenseur est recommandé).

Si le problème n'est pas résolu en suivant les instructions ci-dessus, localisez le numéro de série sur la carte de garantie ou au dos de la télécommande et contactez

Ergomotion® Service à la clientèle : 1-844-534-3676

Téléphone 1-844-534-3676
Fax 1-805-979-9399
Courriel info@ergomotion.com
Site internet www.ergomotion.com

Numéro de série :

+

+

+

+